




راهنمای درخواست آنالیز نمونه توسط دستگاه XRD

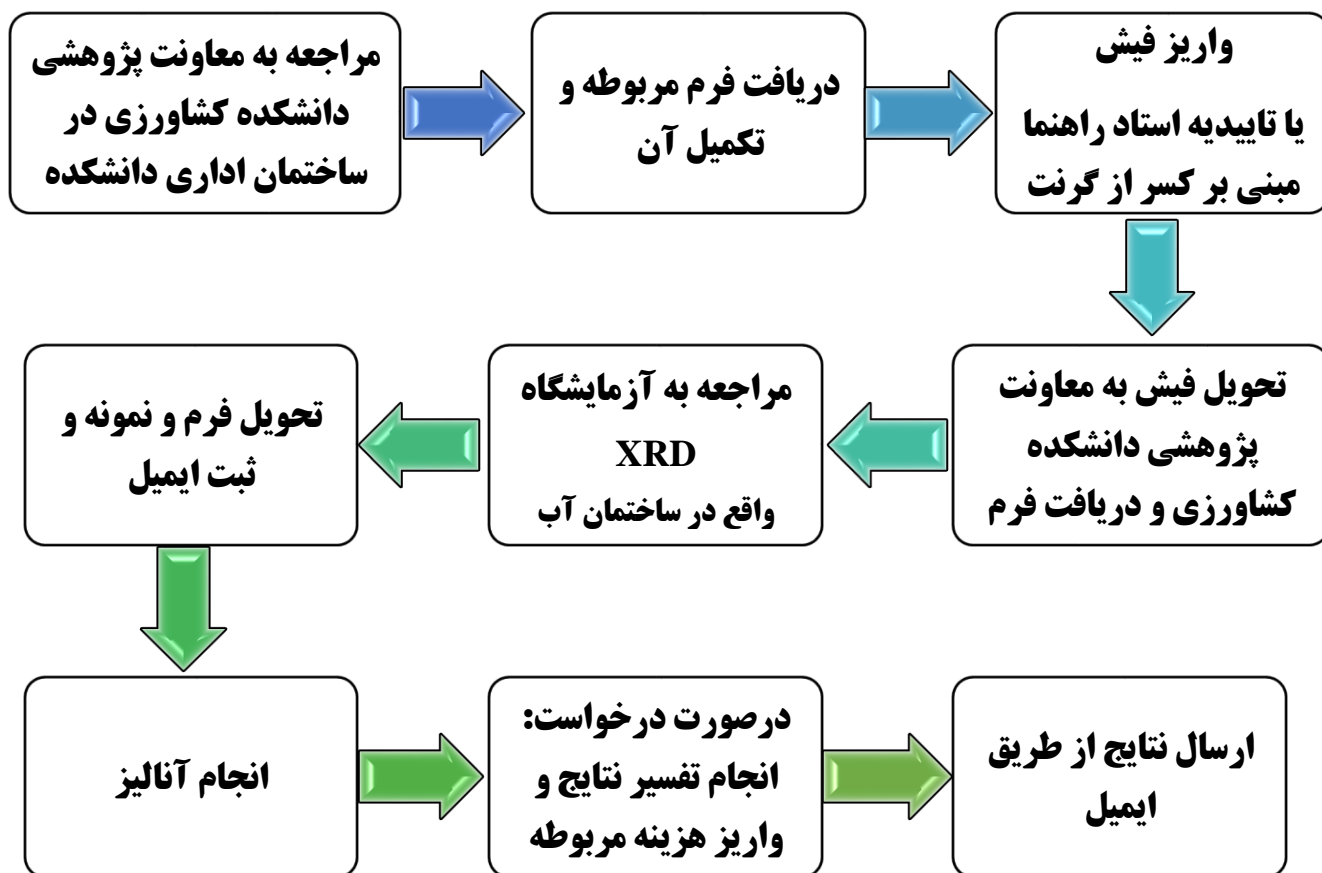

۸۵۰/۰۰۰ ریال	تعرفه خدمات برای داخل دانشگاه و دانشگاههای منطقه ۳
۱/۵۰۰/۰۰۰ اریال	تعرفه خدمات برای خارج از دانشگاه و متقاضیان صنعت
دکتر عباس صمدی	نام و نام خانوادگی مسئول فنی
مهندس ناصر بالنده	نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

توجه:

- نمونه های بودری باید حداقل ۵ گرم وزن داشته باشند و از الک ۲۷۰ مش یا ۰/۰۵ میلی متر عبور داده شده باشند.

- نمونه های فیلم باید به ابعاد حداقل ۲×۲ سانتی متر و روی لام شیشه ای ثابت شده باشند.

- محدوده زاویه دستگاه تا ۸۰ درجه می باشد.

شماره تماس آزمایشگاه: ۳۱۹۴۲۴۳۷-۰۴۴

ایمیل: N.Balandeh@urmia.ac.ir